Active Medical
株式会社アクティブメディカル
アクティブな医学教育の提供を目指す

INNOSONIAN

ブライデン
BRAYDEN

IM13／IM13-R
ILLUMINATING CPR

目で見える胸骨圧迫

● 強く ● 速く ● 絶え間なく ● 圧迫解除

これら4つの基準でひと押しひと押しの質を確認する
新しいBLSトレーニングシミュレーター

有効な胸骨圧迫で
額が光る

- 脳血流を認識できる（メカニズムの理解）
- セルフラーニングに適したモデル
- 経験の浅い指導者にも有益
- 学校教育にも最適

ブライデン

製品番号：IM13（白色）／IM13-R（赤色）

LEDライトの色はどちらかをお選びいただけます。

3部位のLEDライト（額・鎖骨下動脈・頸動脈）が胸骨圧迫の質をフィードバック

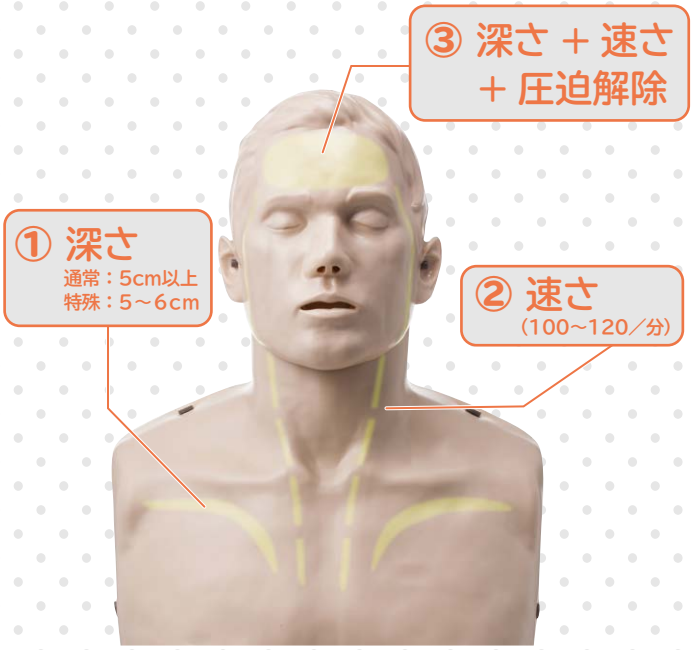

① 深さのライト

①のライトは圧迫の深さを表し、圧迫の深さが5cmより深い時のみ、全て点灯します。

② 速さ（血液循環）のライト

②のライトは圧迫の速さを表します。胸骨圧迫速度が120回を超えた場合、全てが点灯します。

③ 正常循環のライト

③のライトは、ガイドライン通りの胸骨圧迫が行われている場合（圧迫の深さと速さと圧迫解除が正しい場合）にのみ点灯します。

深さの基準は2種類のモードがあり、適宜変更可能です。〈深さの基準　通常：5cm以上　特殊：5～6cm〉

胸骨圧迫の質による点灯の変化

※赤色の丸印は不十分な点灯の仕方を表しています。

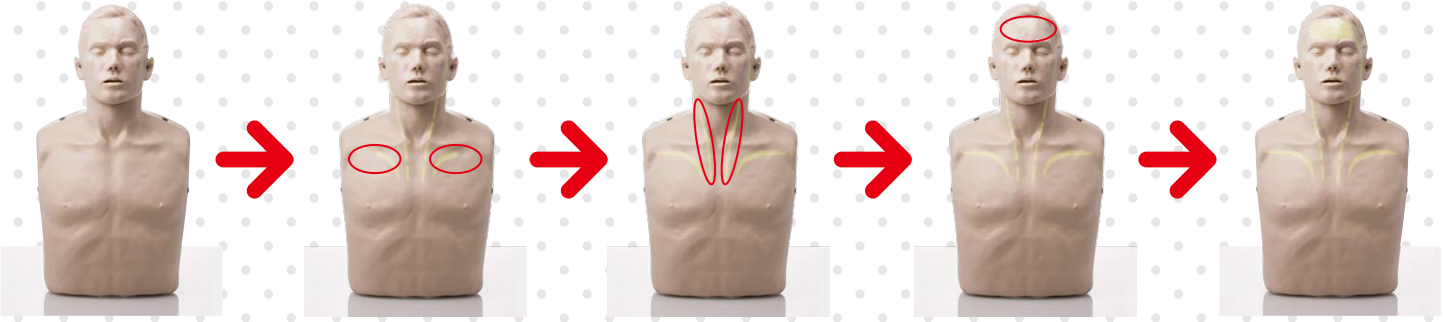

開始前

圧迫が浅い
圧迫が浅く、深さのライトが半分しか点灯していません。

圧迫が速すぎる
圧迫が速いので、速さのライトが繋がって表示されています。

圧迫解除×
速さ・深さは正確ですが圧迫解除不足により、額が光りません。

理想の状態
速さ・深さ・圧迫解除が正確で額が点灯しています。

Active Medical

総発売元：株式会社アクティブメディカル

〒113-0024 東京都文京区西片1-15-15 KDX春日ビル 5F
TEL：03-5842-3015（代表）03-6801-5419（海外事業部ダイヤルイン）
FAX：03-5805-2570
HP：https://actvm.co.jp/　E-mail：medmail@actvm.co.jp
製造元：イノソニアン